


Dräger Safety AG & Co. KGaA, Lübeck

ALCOTEST 9510 IT

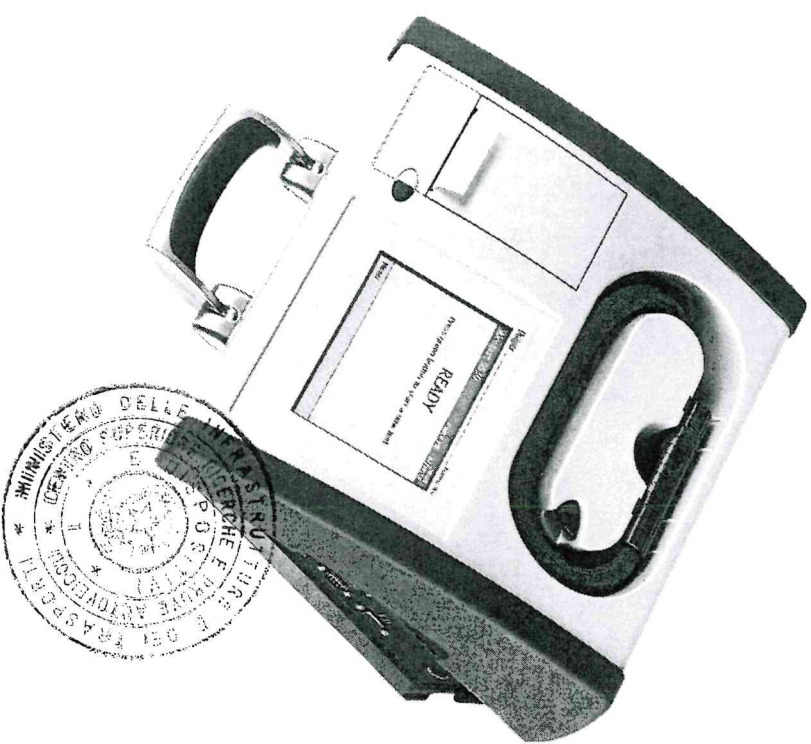

Dräger

Dräger Italia SpA - 20094 Corsico (MI) - Via Galvani, 7

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER L'ETILOMETRO DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara ai sensi dell'art. 186 comma 4 del Codice della Strada, dell'art. 379 del Regolamento di attuazione e del D.M. 22 maggio 1990, n° 196 che l'etilometro sotto indicato è conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti la navigazione, gli affari generali ed il personale - CENTRO SUPERIORE RICERCHE PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI con certificato n.


OM00002/et/18EST001 del **07.03.2024**

Tipo: **ALCOTEST 9510 IT**

N° di serie: **ARUH-0010**

Dichiarazione n°: **36105**

Data: **12-9-2025**

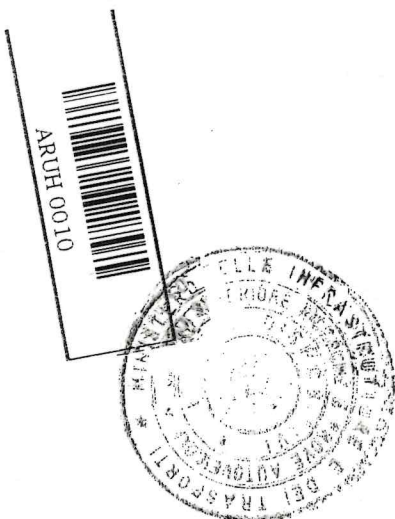

(Firma)

Michele Colangelo
DRAEGER ITALIA SPA (1)

VERIFICA: **PRIMITIVA / PERIODICA (*)**
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

LABORATORIO: **Centro Superiore Ricerche Prove Meccaniche e Dinamiche**
Via di Salaria 950 - Tel. 06 87288 200/298/297/296
00138 ROMA

1) Proprietario

DATA: **30 APR 2026**

DRÄGER Alcotest 9510 ARUH 0010 (856)

2) Proprietario

3) Proprietario

gas di alcool etilico (mg/l)	Valore effettivo banco [mg/l] [g/l]	Esito della verifica.				
		1,5 l in 5 s	3 l in 5 s	4,5 l in 5 s	3 l in 15 s 6 s palter	3 l in 5 s 1,5 s palter
0,000	0,000 0,000		B			
0,200	0,200 0,460		B			
0,350	0,350 0,805	B	B	B	B	B
0,400	0,400 0,920		B			
0,700	0,700 1,610		B			
0,950						
1,500	1,500 2,450		B			
2,500						
PRIMITIVA 30.04.2026 BANCO 036						

riempire le caselle interessate

con B per i risultati esatti

con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

AGGIORNAMENTO PARAMETRI STANDARD: S/NO

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO/RESPINTO (*)

(*) Cancellare l'indicazione inutile
Versamento in c/c
postate ai sensi
dell'art. 3 del D.P.R.
30.12.1962 N. 955

(firma del responsabile del laboratorio)